Entretien de votre stérilisateur M9/M11...

Entretien hebdomadaire

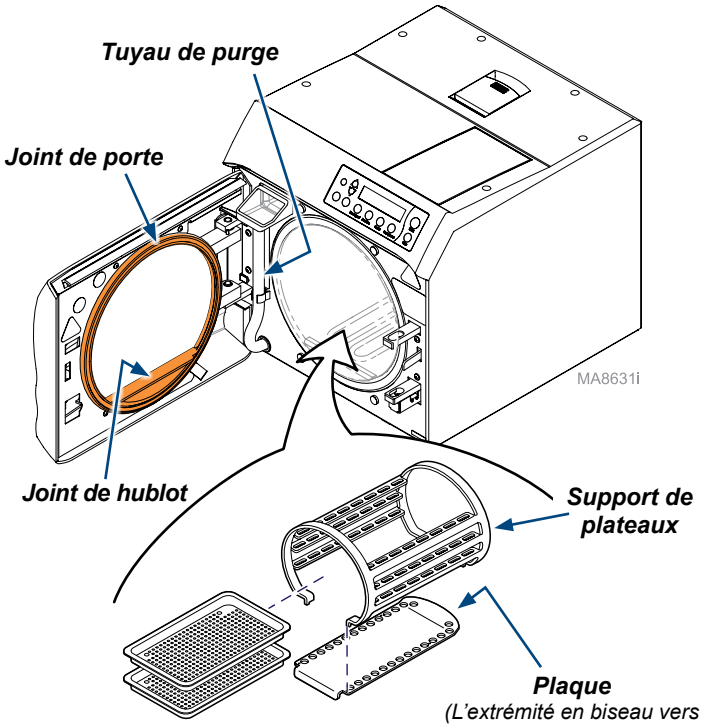
Tuyau de purge
Joint de porte
MA8631i
Joint de hublot
Support de plateaux
Plaque
(L'extrémité en biseau vers l'arrière de la cuve doit se trouver à l'arrière de la cuve)

• Nettoyage des surfaces externes et des joints

> **Attention**
> *Pour éviter les brûlures, laisser refroidir l'appareil avant de nettoyer les joints et les surfaces internes.*

A) *Nettoyer les surfaces externes et les joints avec un chiffon doux et du détergent/savon doux.*
B) *Vérifiez que les joints de porte ne sont pas endommagés.*

• Nettoyage des surfaces internes

> **Avertissement concernant l'équipement**
> *Ne pas changer l'eau peut entraîner un dysfonctionnement du stérilisateur.*

A) *Purger l'eau du réservoir à l'aide du tuyau de purge situé à l'avant de l'appareil.*
B) *Nettoyer l'intérieur de la cuve, le support, les plateaux et les plaques avec un savon doux ou le Speed-Clean et de l'eau distillée.*
C) *Remplir le réservoir d'eau distillée propre.*

Entretien mensuel

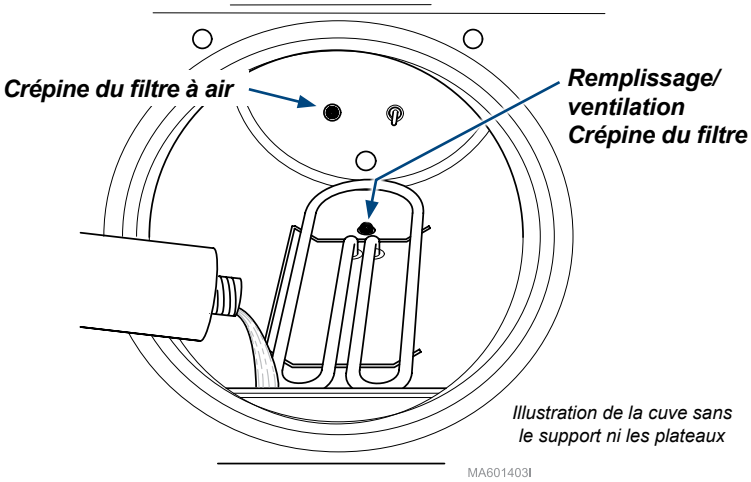

Illustration de la cuve sans le support ni les plateaux

> **AVERTISSEMENT**
> ***Ne pas stériliser d'instruments pendant le nettoyage du stérilisateur.***

> **Avertissement concernant l'équipement**
> *Ne pas nettoyer le système avec le produit **Speed-Clean** ou utiliser un (d')**autre(s)** nettoyant(s) stérilisant peut entraîner une défaillance prématurée des composants du stérilisateur.*

• Système de vidange

A) *Après refroidissement de la cuve, purger le réservoir et le remplir d'eau distillée propre. Ajouter 30 ml (1 oz) de nettoyant Speed-Clean directement dans le bas de la cuve.*
B) *Lancer un cycle **Pouches** (sachets).*
C) *Appuyer sur le bouton **Stop** lorsque le cycle de séchage débute.*
D) *Purger le réservoir et le remplir d'eau distillée propre.*
E) *Rincer en lançant un cycle **Unwrapped** (non emballé).*
F) *Vider le réservoir et le remplir avec de l'eau distillée et propre avant de laisser refroidir le stérilisateur.*

• Nettoyer les crépines de filtres (de remplissage/de ventilation/d'air)

> **Avertissement concernant l'équipement**
> *Ne pas utiliser le stérilisateur si les filtres ne sont pas en place.*

A) *Laisser refroidir le stérilisateur, puis retirer les plateaux, le support et la plaque.*
B) *Voir illustration pour l'emplacement des crépines de filtres.*
C) *Tirer sur/déformer le filtre pour le retirer. (Si nécessaire, utiliser une pince).*
D) *Nettoyer les filtres avec le Speed-Clean et de l'eau distillée. [Remplacer les filtres si les débris ne peuvent être enlevés lors du nettoyage.]*
E) *Rincer les filtres à l'eau distillée.*
F) *Disposer les filtres. (Pousser vers l'intérieur tout en les déformant légèrement).*
G) *Reposer la plaque, le support et les plateaux.*

• Contrôle de la vanne de surpression*

• Retirer/nettoyer/vérifier les joints*

**** Voir le manuel d'installation/d'opération pour une liste exhaustive des procédures de maintenance***

Utilisation de votre stérilisateur M9/M11...

Pour lancer un cycle...

AVERTISSEMENT
Le lot n'est pas stérile si l'on appuie sur le bouton Stop avant le début du cycle de séchage.

*A) Appuyer sur le **bouton de cycle** désiré.*
(Voir « Paramètres de cycle » pour les températures/durées).
*B) Appuyer sur le bouton **Start**.*

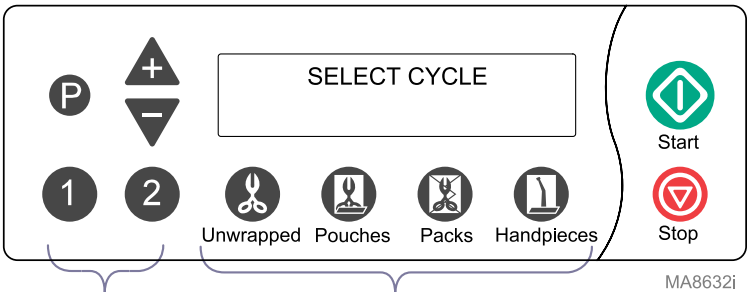

Pour programmer les boutons de cycle...

Attention
La température de stérilisation peut être réglée de 110 °C (230 °F) au minimum à 135 °C (275 °F) au maximum. La plage de températures autorisées pour une stérilisation adéquate est de 121° à 135 °C (250°- 275 °F). Les températures inférieures à 121 °C (250 °F) ne doivent pas être utilisées pour la stérilisation, sauf mention contraire du fabricant de l'instrument. Les températures inférieures à 121 °C (250 °F) ne sont proposées que pour la désinfection.

Étape	Action	Description
1	**Appuyer sur le bouton désiré :** 1 2	Permet de sélectionner le bouton qui sera programmé.
2	**Appuyer sur :** P	Programme de réglage de la température de stérilisation (3 à 90 minutes)
	Régler : + −	Les boutons « + » et « – » permettent de régler la température par incréments de 1°.
3	**Appuyer sur :** P	Programme de réglage de la durée de stérilisation
	Régler : + −	Les boutons « + » et « - » permettent de régler la durée par incréments de 1 minute.
4	**Appuyer sur :** P	Programme de vitesse de ventilation
	Régler : + −	Appuyer sur « + » pour passer en mode FAST (rapide) Appuyer sur « - » pour passer en mode SLOW (lent)
5	**Appuyer sur :** P	Programme de réglage de la durée de séchage (0 à 60 minutes)
	Régler : + −	Les boutons « + » et « - » permettent de régler la durée par incréments de 1 minute.
6	**Appuyer sur :** P	L'écran affichera les nouveaux paramètres de cycle.

REMARQUE :
Pour annuler les modifications et revenir aux paramètres initiaux lors de la procédure, appuyer sur le bouton STOP.
Les paramètres programmés sont mémorisés sous le bouton de programme n° <1> ou <2>. Les réglages seront mémorisés même en cas de panne de courant ou de débranchement de l'appareil.

Paramètres de cycle		
Non emballés	**132 °C (270 °F)** **186 kPa (27.1 psi)** **Stérilisation : 3 min.** **Séchage : 30 min.***	• **Instruments en vrac sur un plateau.** • **Cartouches en verre ou en métal ouvertes.** • **Tubulure non utilisée dans les interventions chirurgicales.** • **Instruments en vrac pour lesquels les fabricants recommandent une exposition à 132 °C (270 °F).** *Remarque : L'exposition à un environnement non stérile peut nuire à la stérilité des instruments non emballés.*
Sachets	**132 °C (270 °F)** **186 kPa (27.1 psi)** **Stérilisation : 5 min.** **Séchage : 30 min.***	• **Instruments en sachets ou emballés légèrement.** • **Plusieurs couches d'instruments séparées par du tissu.** • **Plateaux emballés d'instruments en vrac.** • **Tubulure non utilisée dans les interventions chirurgicales.** • **Instruments emballés pour lesquels les fabricants recommandent une exposition à 132 °C (270 °F).**
Paquets	**121 °C (250 °F)** **104 kPa (15 psi)** **Stérilisation : 30 min.** **Séchage : 30 min.***	• **Textiles et paquets chirurgicaux emballés pour la stérilisation.** • **Instruments, sauf liquides, pour lesquels les fabricants recommandent une exposition à 121 °C (250 °F) pendant 30 minutes.**
Pièces à main	**132 °C (270 °F)** **186 kPa (27.1 psi)** **Stérilisation : 6 min.** **Séchage : 30 min.***	• **Pièces à main dentaires (emballées ou non)** *Remarque : Vérifier l'adéquation des paramètres de stérilisation auprès du fabricant de pièces à main.*
1 2 Programmation définie par l'utilisateur	**110 °C (230 °F) à 135 °C (275 °F)** **41 à 214 kPa (6 à 31 psi)** **Stérilisation : 3 à 90 min.** **Séchage : 0 à 60 min.**	• Instruments appropriés pour les paramètres définis par l'utilisateur. ***Attention*** Les températures inférieures à 121 °C (250 °F) ne doivent être utilisées que pour la désinfection.

** La durée de séchage peut varier entre 0 et 60 minutes. Voir **Fonctionnement de cycle** dans le manuel d'installation/d'opération.*

© Midmark Corporation 2012